
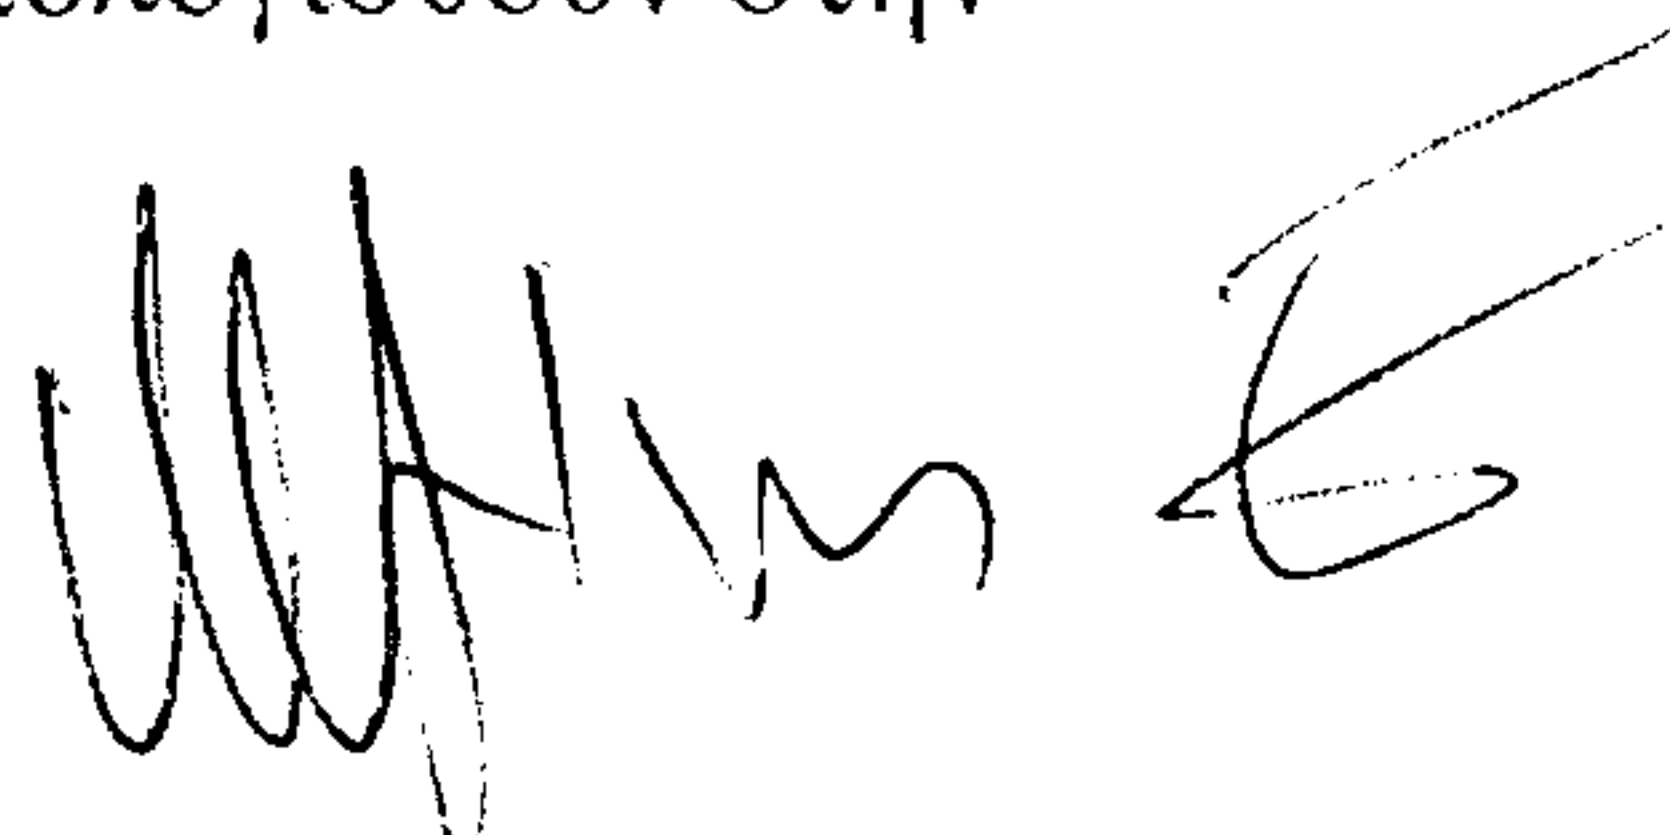


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

1. Να διαθέτει ωφέλιμο όγκο τουλάχιστον 90 λίτρων
2. Να μην χρειάζεται ειδικό χώρο ή σωληνώσεις για εγκατάσταση, εξαέρωση και σύστημα ελέγχου
3. Η θερμοκρασία αποστείρωσης να είναι ως 55° C η μέγιστη
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 κύκλους αποστείρωσης, ένα ταχύτερο και ένα μεγαλύτερο 60 λεπτά το πολύ
5. Ο κλίβανος να είναι δίθυρος, οι πόρτες να ανοίγουν αυτόματα **κατά προτίμηση** ή χειροκίνητα και **η κίνηση να είναι οπωσδήποτε κάθετη, λόγω περιορισμένου χώρου**
6. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη όλη η λειτουργία, ώστε να ελέγχεται εύκολα κάθε στάδιο στη φάση της αποστείρωσης. Όλη η ανωτέρω διαδικασία να φέρει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο
7. Η συσκευασία του H₂ O₂ να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στο χρήστη. Να περιγραφεί η παρεχόμενη ασφάλεια της συσκευασίας
8. Να εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν μικρότερη, ισόποση κατανάλωση H₂O₂ ανά κύκλο αποστείρωσης.
9. Να διαθέτει συστήματα προειδοποίησης για την ασφαλή χρήση της συσκευής και ηχητική προειδοποίηση σφαλμάτων και την ακύρωση ενός κύκλου.
10. Να εμφανίζει μήνυμα ολοκλήρωσης του κύκλου στην οθόνη και κατά προτίμηση ηχητική ειδοποίηση.
11. Ο χρόνος αναμονής κατά την ακύρωση, να είναι μικρός και όχι μεγαλύτερος των 15 λεπτών. Το σύστημα να επανέρχεται αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας.
12. Να διαθέτει τροχούς για την εύκολη μετακίνηση του.
13. Να διαθέτει 2 μετακινούμενα ράφια.
14. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή, προκειμένου να εκτυπώνονται και να φυλάσσονται τα δεδομένα της διεργασίας(χρόνοι, κύκλοι, χειριστές).
15. Να διαθέτει αναλώσιμα όπως χημικούς δείκτες H₂O₂, βιολογικούς δείκτες, χαρτί αποστείρωσης, σακούλες αποστείρωσης, κλπ., επίσημα ελεγμένα και πιστοποιημένα για την λειτουργία του κλιβάνου από τον κατασκευαστικό οίκο. Ο προσφερόμενος τιμοκατάλογος αναλωσίμων να ισχύει για 3 έτη τουλάχιστον από την κατάθεση.
16. Να συνοδεύεται από κατάλληλο επωαστήρα βιολογικών δεικτών και πλήρη σειρά αναλωσίμων για 100 τουλάχιστον κύκλους αποστείρωσης 100 βιολογικούς δείκτες, 300 χημικούς δείκτες strips, 200 μέτρα ρολό αποστείρωσης πλάτους 20 εκ. ή 200 σακούλες αποστείρωσης αντιστοίχως. Να δοθούν τιμές αυτών που θα συνυπολογισθούν στην ανοιγμένη τιμή.

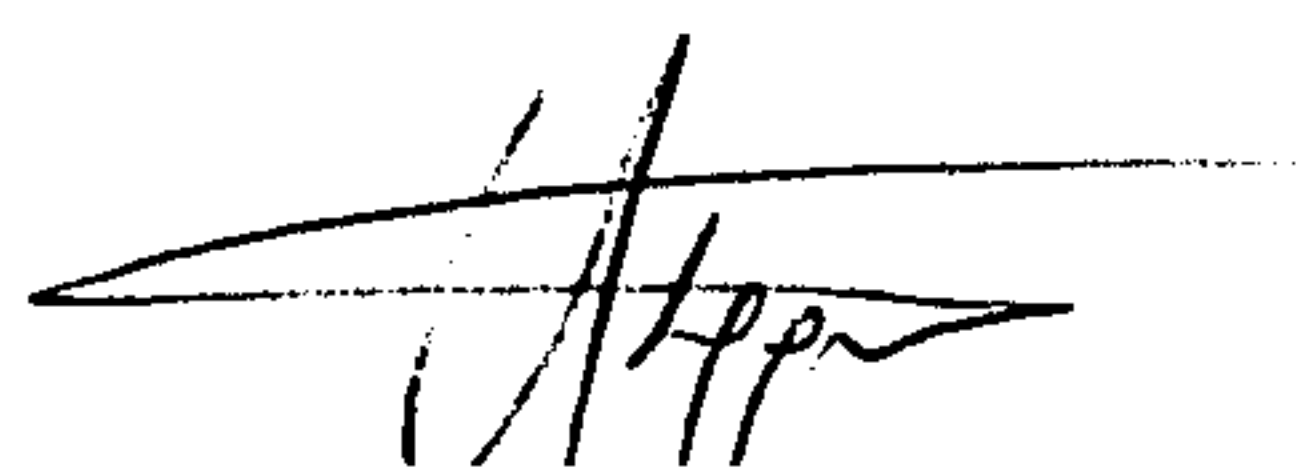

17. Να επισυναφθεί κατάλογος ,εφ' όσον υπάρχει, με ήδη εγκατεστημένους σε λειτουργία κλιβάνους με τα αντίστοιχα νοσοκομεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οπωσδήποτε θα πρέπει:

1. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς επίσης και την περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος.
2. Θα γίνει εκπαίδευση τεχνικών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) με έξοδα της εταιρείας και χρηστών στο χώρο του Νοσοκομείου και να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, το οποίο θα πρέπει **απαραίτητα** να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα, error code & part list.
3. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών.
4. Να έχει CE mark και ο προμηθευτής πιστοποίηση κατά ISO
5. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία που το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία και η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλες τις προδιαγραφές.
6. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν συνταχθεί βάση του Π.Δ. 118/2007